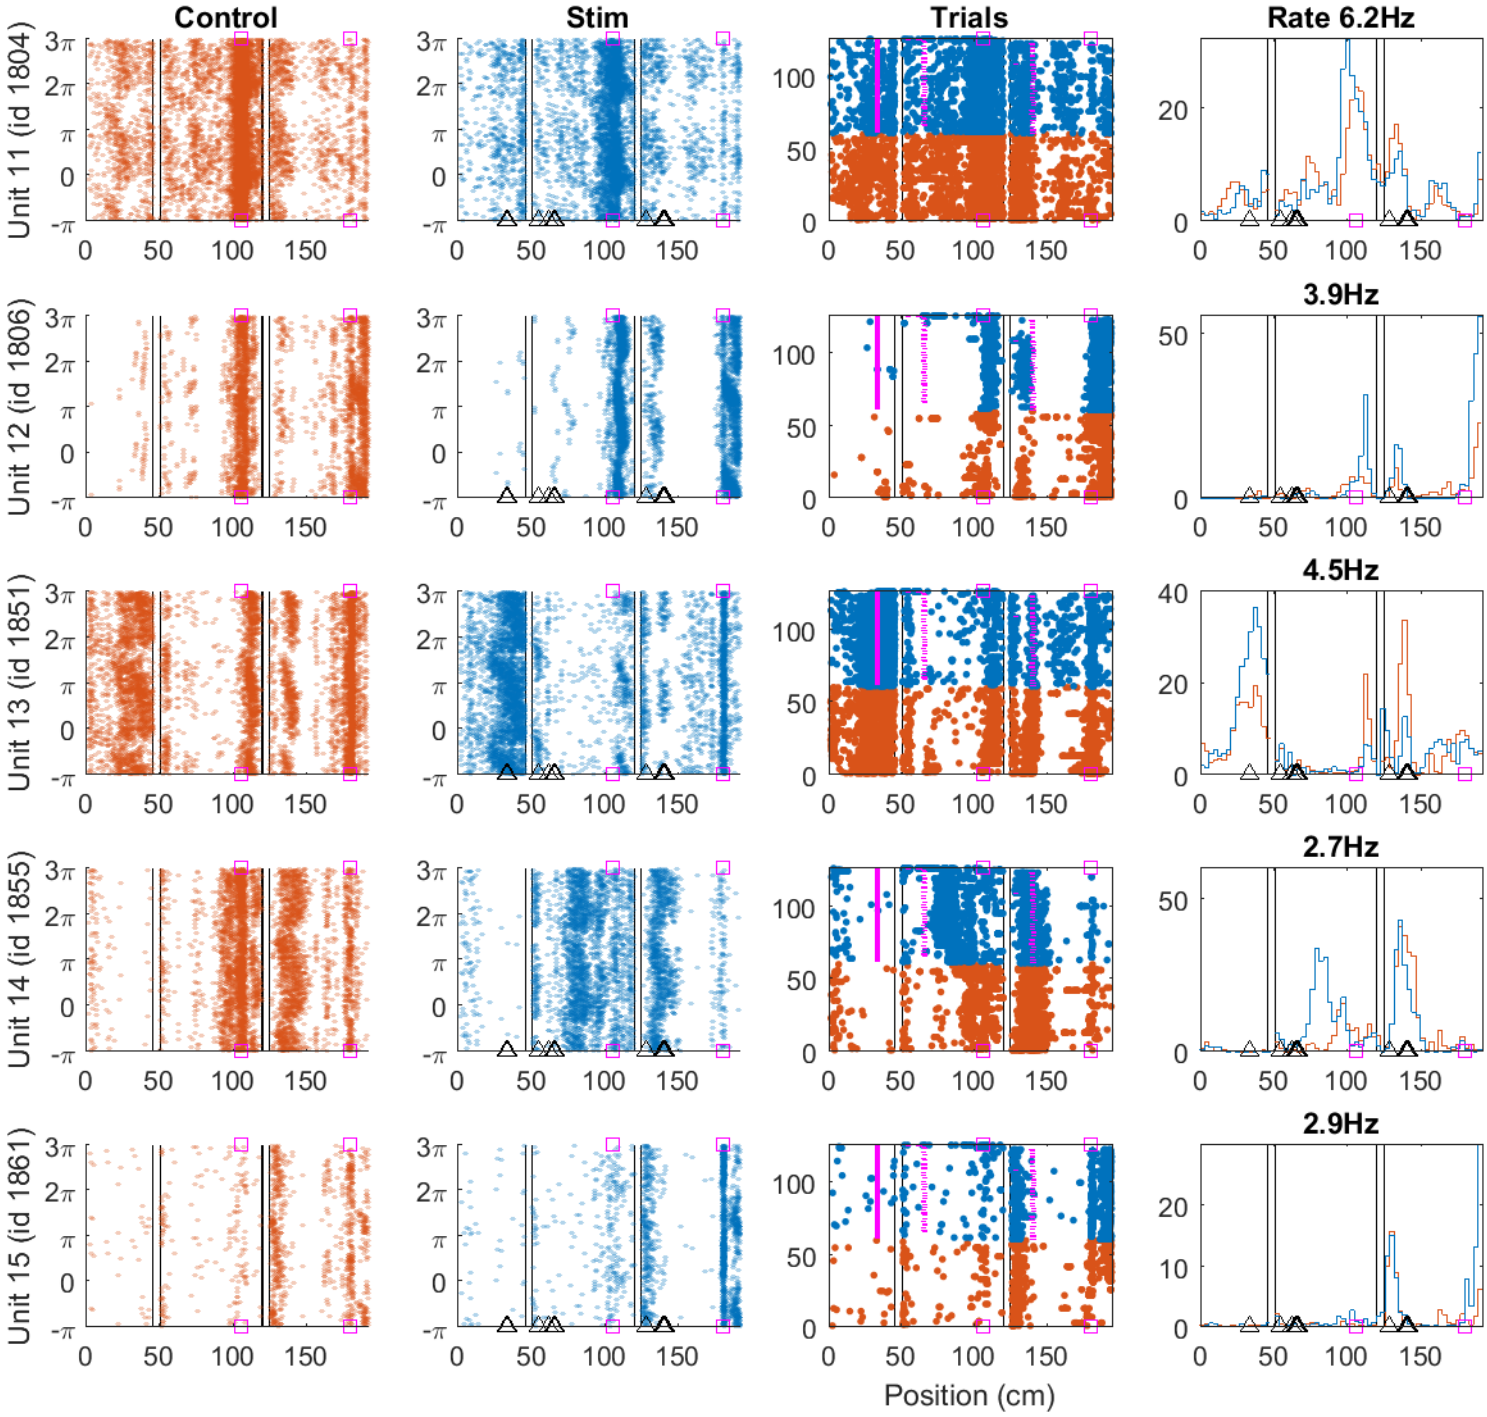
Control
Stim
Trials
Rate 6.2Hz
3.9Hz
4.5Hz
2.7Hz
2.9Hz
Unit 11 (id 1804)
Unit 12 (id 1806)
Unit 13 (id 1851)
Unit 14 (id 1855)
Unit 15 (id 1861)
3π
2π
π
0
-π
0
50
100
150
Position (cm)