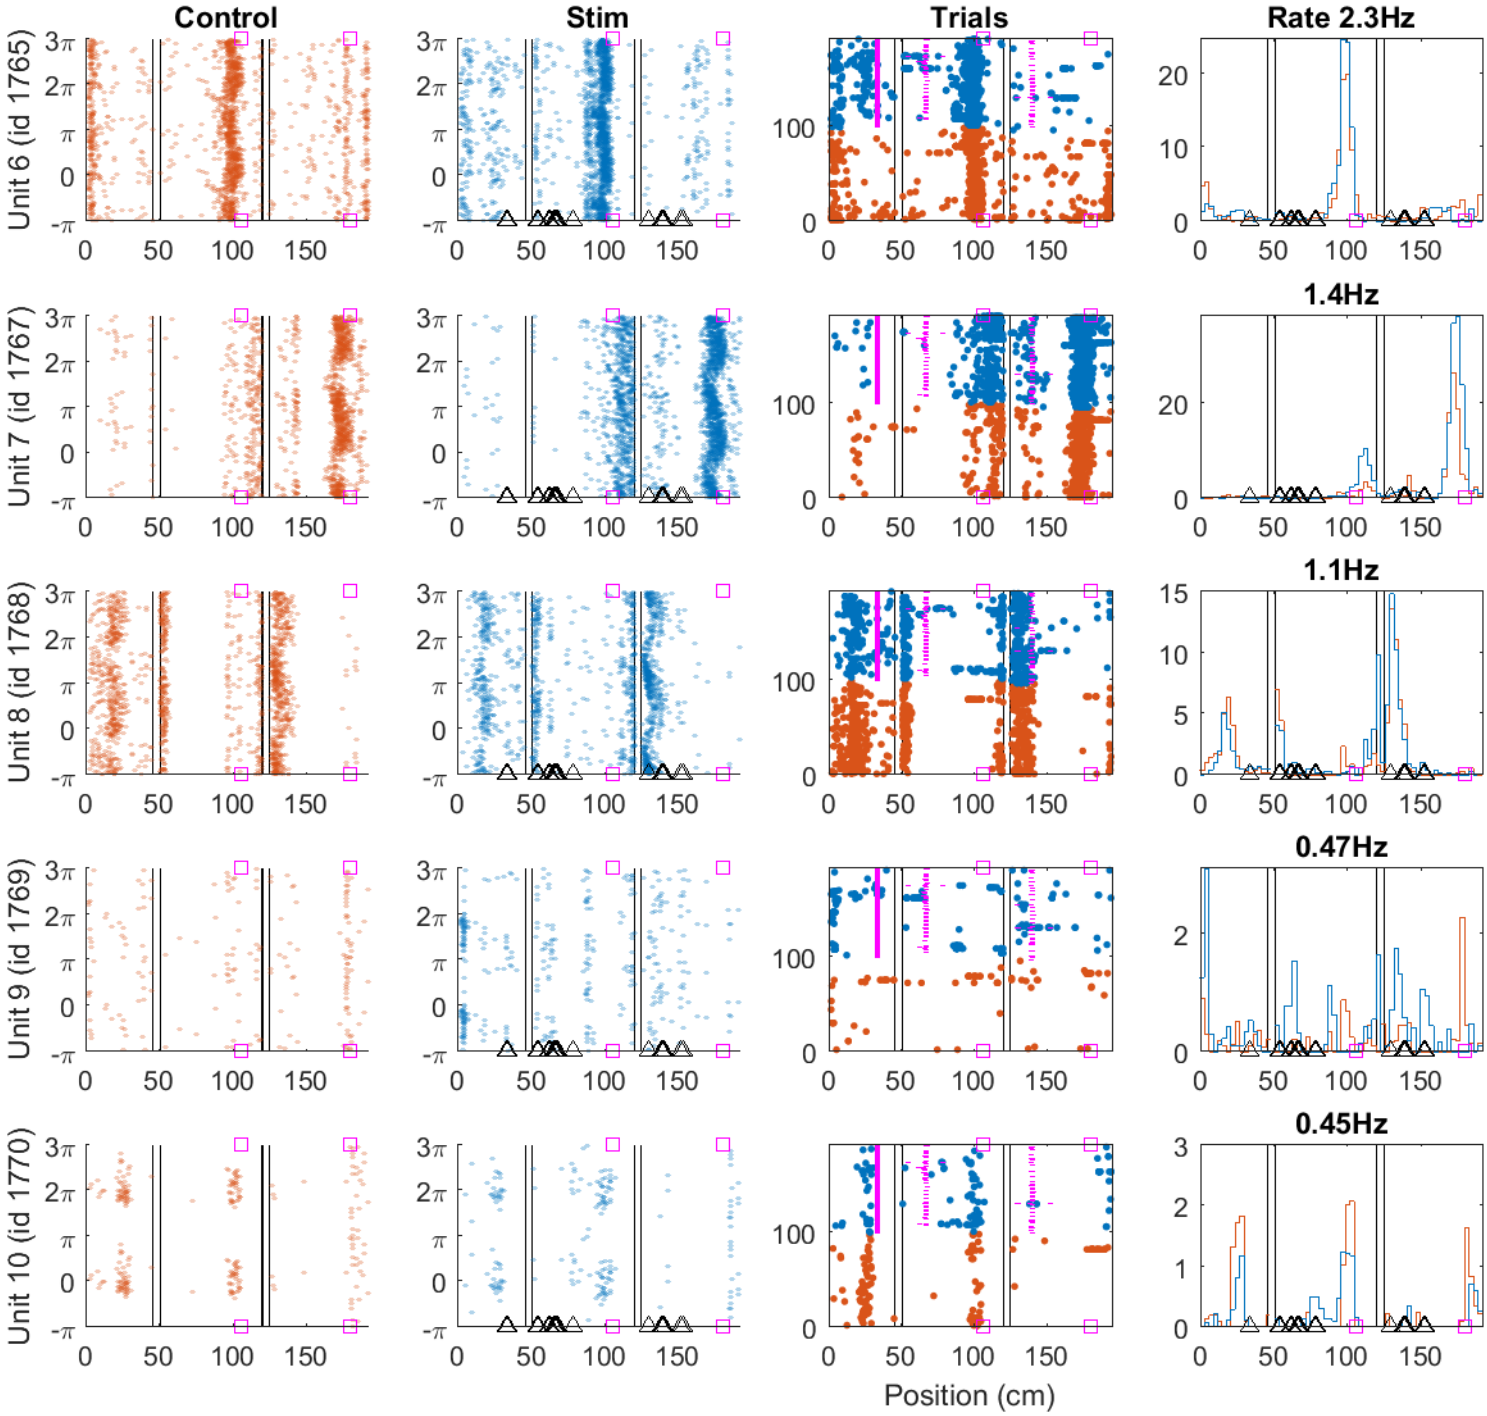
Control
Stim
Trials
Rate 2.3Hz
1.4Hz
1.1Hz
0.47Hz
0.45Hz
Unit 6 (id 1765)
Unit 7 (id 1767)
Unit 8 (id 1768)
Unit 9 (id 1769)
Unit 10 (id 1770)
3π
2π
π
0
-π
0
50
100
150
Position (cm)